QUEST® MPS®
Système de protection myocardique

REF **5001032** Kit de conversion du bloc de verrouillage MPS®2 1 APPAREIL

Usage prévu :
Le kit de conversion de bloc de verrouillage MPS2 doit être utilisé pour remplacer le bloc de verrouillage MPS2 par le bloc de verrouillage de l'échangeur thermique MPS2 à 10-16 circonvolutions.

Contre-indications :
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec la console et les produits jetables Quest MPS2. Son utilisation avec d'autres systèmes est contre-indiquée. Cet appareil n'est pas conçu, ne peut être vendu ni être destiné pour une utilisation autre que celle spécifiée.

Avertissements et mises en garde :

1. Lire soigneusement les instructions. Le médecin traitant est seul responsable de la configuration et de l'utilisation de ce dispositif. Se référer au manuel d'exploitation du système MPS pour obtenir des instructions d'utilisation complètes.
2. À utiliser UNIQUEMENT avec la console MPS. NE PAS utiliser à d'autres fins. Toutes les réclamations seront sans effet en cas d'utilisation différente.
3. Défaire les trois emballages et les examiner pour s'assurer qu'aucun dommage n'a eu lieu au cours du transport. NE PAS UTILISER de composants endommagés.
4. La prise électrique de qualité hospitalière ou une prise appropriée doit être correctement mise à la terre.
5. La loi fédérale (américaine) limite la vente de cet appareil à la commande d'un médecin.
6. Respecter tous les avertissements supplémentaires et les mises en garde contenues dans les directives d'utilisation suivantes.

Instructions d'installation

1. IMPORTANT : Avant l'installation, fixer le tuyau d'amenée d'eau pour éviter les débordements lors de la conversion.

2. Retirer les quatre vis qui fixent le bloc de verrouillage à l'échangeur thermique. Retirer le bloc de verrouillage.

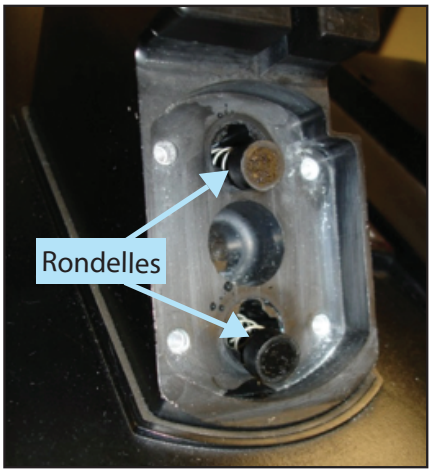

3. Veiller à ce que les rondelles restent sur les ressorts.

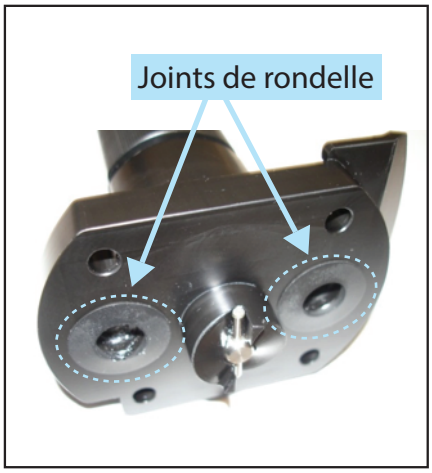

4. Veiller à ce que les joints de rondelle soient bien en place dans les découpes en cercle sur le nouveau bloc de verrouillage.

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx

℞ ONLY

CE 0123

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

QUEST Medical, Inc.

One Allentown Parkway | Allen, Texas 75002 U.S.A. | +1 972 390-9800 | +1 800 627-0226
©2017 Quest Medical, Inc. MPS est une marque déposée de Quest Medical, Inc. La console MPS et les produits MPS stériles jetables sont protégés par un ou plusieurs des brevets américains suivants :
5,385,540 - 5,573,502 - 5,588,816 - 5,638,737 - 5,645,531 - 5,899,873.
Ils sont également protégés par des brevets américains et internationaux en attente et par des demandes de brevets.

Fabriqué aux États-Unis
904516 REV B
JUNE 19

QUEST® MPS®
Système de protection myocardique

5. Placer le nouveau bloc de verrouillage sur les rondelles. Aligner les rondelles sur les trous fournis dans l'échangeur thermique à l'aide d'une pince hémostatique {2>pour appuyer sur les ressorts.

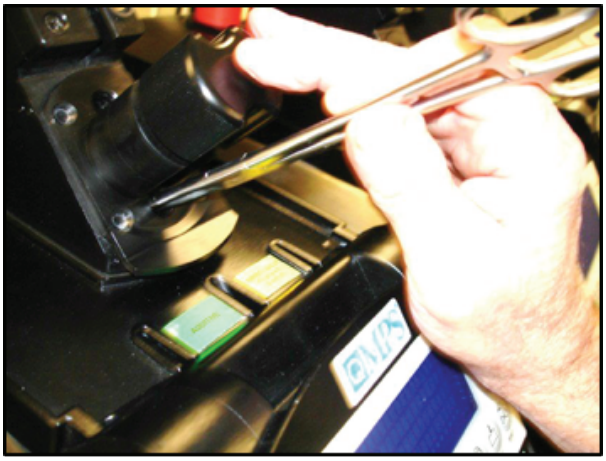

6. Appuyer légèrement sur le bloc de verrouillage poule le mettre en place tout en maintenant les deux rondelles alignées. Le bloc de verrouillage doit être à plat contre la partie inférieure de l'échangeur thermique. Les rondelles doivent être positionnées contre les joints de rondelle.

7. Maintenir le bloc de verrouillage en place et remettre les quatre vis. Bien serrer chaque vis.

8. Rebrancher les amenées d'eau et retirer les pinces du tuyau.

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx

℞ ONLY

CE 0123

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

QUEST Medical, Inc.

One Allentown Parkway | Allen, Texas 75002 U.S.A. | +1 972 390-9800 | +1 800 627-0226
©2017 Quest Medical, Inc. MPS est une marque déposée de Quest Medical, Inc. La console MPS et les produits MPS stériles jetables sont protégés par un ou plusieurs des brevets américains suivants :
5,385,540 - 5,573,502 - 5,588,816 - 5,638,737 - 5,645,531 - 5,899,873.
Ils sont également protégés par des brevets américains et internationaux en attente et par des demandes de brevets.

Fabriqué aux États-Unis
904516 REV B
JUNE 19

QUEST® MPS®
Système de protection myocardique

Activer la position de l'échangeur thermique à 16 circonvolutions

Commencer par la position déverrouillée en 10 C.

1. Enfoncer le bouton et le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 360 degrés jusqu'à ce qu'il s'arrête de tourner. (Le bouton de verrouillage se prolongera vers l'extérieur)

2. Le bouton est maintenant dans la position déverrouillée à 16 circonvolutions.

Activer la position de l'échangeur thermique à 10 circonvolutions

Commencer par la position déverrouillée en 16 C.

1. En enfonçant le bouton, le faire tourner à 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2. Les renfoncements arrondis sur les deux parties du bouton doivent être maintenant alignés.

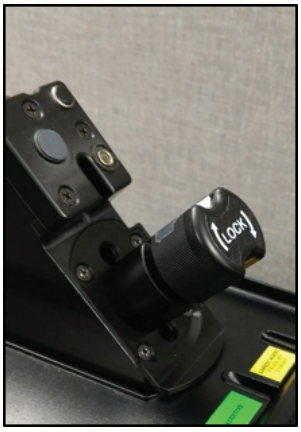

3. Le bouton est maintenant dans la position déverrouillée à 10 circonvolutions.

Si vous avez des difficultés à verrouiller un échangeur thermique, vérifier que le bloc de verrouillage est correctement configuré pour le dispositif jetable que vous souhaitez installer. Consulter les instructions d'utilisation fournies avec le dispositif jetable pour l'installer. Lorsque vous aurez terminé d'utiliser cette fiche d'instructions de référence, veuillez la fixer au dos de votre manuel MPS.

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx

℞ ONLY

CE 0123

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

QUEST Medical, Inc.

One Allentown Parkway | Allen, Texas 75002 U.S.A. | +1 972 390-9800 | +1 800 627-0226
©2017 Quest Medical, Inc. MPS est une marque déposée de Quest Medical, Inc. La console MPS et les produits MPS stériles jetables sont protégés par un ou plusieurs des brevets américains suivants :
5,385,540 - 5,573,502 - 5,588,816 - 5,638,737 - 5,645,531 - 5,899,873.
Ils sont également protégés par des brevets américains et internationaux en attente et par des demandes de brevets.

Fabriqué aux États-Unis
904516 REV B
JUNE 19